


Parkett Seitenparkett Estrade


Seitenparkett Reihe 2: Induktionsanlage für
Hörgeräte bzw. Cochlea - Implantate


Legende:
○ = Dienstsitz

Ansteigende Estrade:
(Seitenansicht)

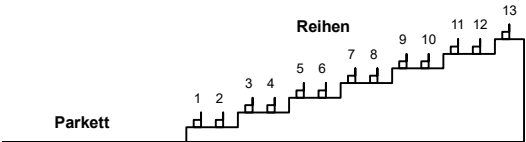

Der Saalplan entspricht nicht
den genauen Gegebenheiten vor Ort.

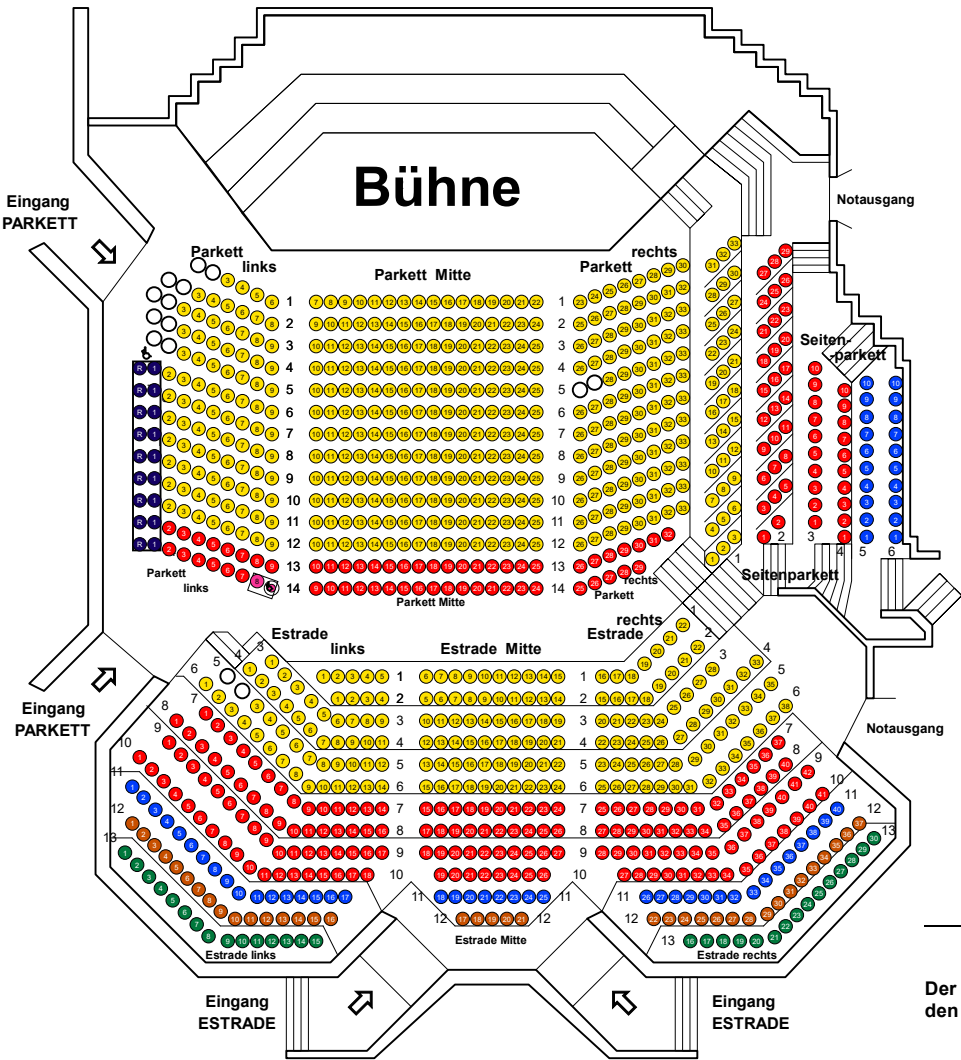

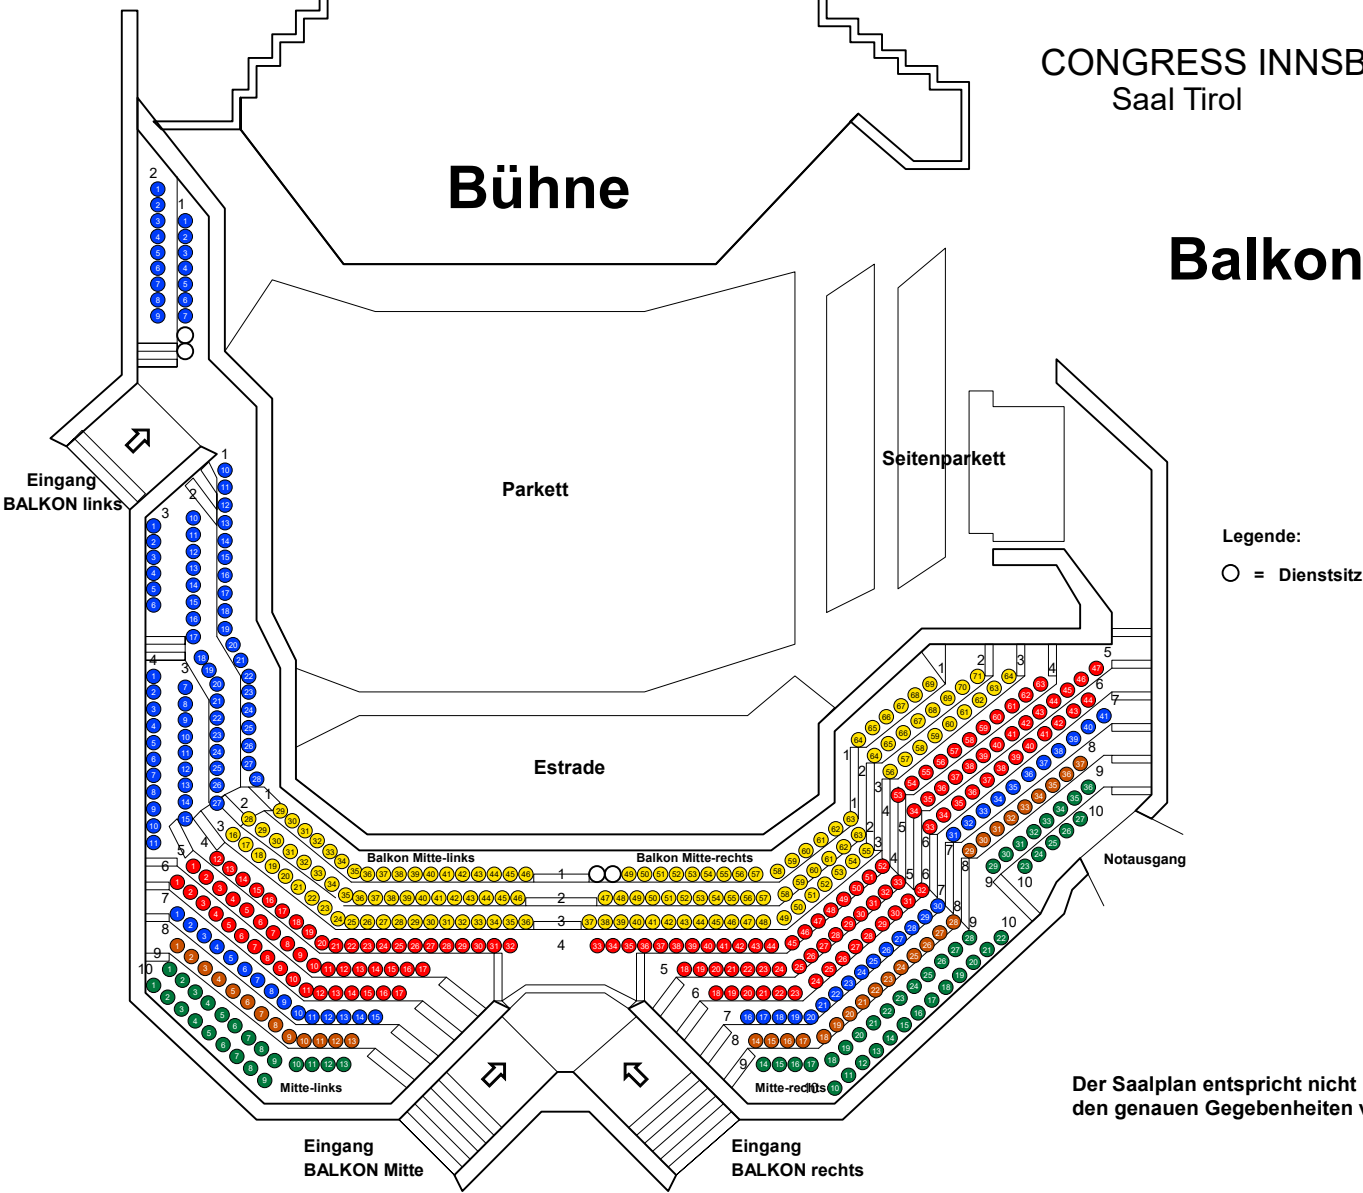

Der Saalplan entspricht nicht
den genauen Gegebenheiten vor Ort.